

Evaluatie volumebepalingssysteem 2020



Evaluatie Volumebepalingsysteem

2020

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, opgeslagen in een gegevensopzoeksysteem of in enigerlei andere vorm of op enigerlei andere wijze worden verspreid, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, microfilm of op andere wijze, zonder de schriftelijke toestemming van Gasunie Transport Services B.V.

Gasunie Transport Services B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van, of voor schade die voortvloeien uit het gebruik van enigerlei informatie die wordt beschreven in dit document.

1. INHOUDSOPGAVE

1. INHOUDSOPGAVE	2
2. DEFINITIES & SYMBOLEN.....	3
3. SAMENVATTING / CONCLUSIE	4
4. DATA BESCHIKBAARHEID	5
4.1. Functionele eisen	5
4.2. Realisatie periode 2020.....	5
5. STORINGSDUUR METING EN/OF DATA ACQUISITIE.....	6
5.1. Functionele eisen	6
5.2. Realisatie periode 2020.....	6
6. GASMETER	7
6.1. Functionele eisen	7
6.2. Realisatie jaarlijkse steekproef gasmeters over de periode 2020	7
6.2.1 Flowgewogen gemiddelde miswijzing bij de hoogste druk waarbij is gekalibreerd	7
7. VOLUMEHERLEIDINGSINSTRUMENT (EVHI)	9
7.1. Functionele eisen	9
7.2 Realisatie EVHI's over de periode 2020	9
7.2.1 Herleidingsfout	9
7.2.2 Verschil herleidingsfout tussen 2 metingen.....	10
7.2.3 Fout drukopnemer	11
7.2.4 Fout temperatuuropnemer	11
7.2.5 HF/LF-fout	12
8. TESTGASRESULTATEN	13
8.1. Functionele eis.....	13
8.2. Realisatie periode 2020.....	13
9. MEETONZEKERHEID	14
9.1. Functionele eisen	14
9.2. Realisatie meetonzekerheid voor de periode 2020	14
REFERENTIELIJST	16

2. DEFINITIES & SYMBOLEN

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de definities en symbolen die in deze beschrijving gebruikt worden en die niet beschreven staan in de 'Begrippencode Gas' [1]. Daar waar mogelijk is gebruik gemaakt van de definities zoals vastgelegd in relevante ISO normen [2], [3].

<i>afwijking (B)</i>	resultaat van de kalibratie.
<i>EVHI</i>	Elektronisch volumeherleidingsinstrument. Een EVHI zet de door de gasmeter geregistreerde kubieke meters gas onder bedrijfscondities (niet herleid volume) om naar kubieke meters gas onder normaal condities (herleid volume).
<i>fout (F)</i>	het verschil tussen de gemeten waarde en de ware waarde.
<i>HF</i>	hoog frequent signaal, contactloos vanuit het binnenwerk van de gasmeter.
<i>H_s</i>	symbool gebruikt voor het aanduiden van de calorische bovenwaarde. Eenheid [MJ/m ³ (n)]
<i>kalibreren</i>	vaststellen van het verschil tussen de gemeten waarde en het referentiemiddel binnen een gedefinieerd meetbereik.
<i>LF</i>	laag frequent signaal, vanaf het mechanisch telwerk van de gasmeter.
<i>maximaal toelaatbare fout (MTF)</i>	hoogste toegestane waarde van de fout.
<i>onzekerheid</i>	tweemaal de standaarddeviatie van een kansverdeling, uitgaande van een normaal verdeling.
<i>referentiemiddel</i>	apparaat of systeem dat voor kalibratie wordt gebruikt en met gekende onzekerheid de ware waarde representeert.
<i>significantieniveau (SCN)</i>	de gekende onzekerheid van het referentiemiddel.

3. SAMENVATTING / CONCLUSIE

In de Meetcode gas - LNB worden eisen gesteld aan de bepalingsmethodiek van de totale geleverde energiehoeveelheid. Deze energiehoeveelheid wordt bepaald uit het gasvolume en de calorische waarde. Het volumebepalingsysteem bepaalt het volume op een aansluiting en systeemverbinding. Het gaskwaliteitsysteem bepaalt de calorische waarde op een aansluiting en systeemverbinding.

In dit rapport wordt de jaarlijkse evaluatie beschreven van het volumebepalingsysteem over de periode 2020, als genoemd in artikel 4.5.1 van de Meetcode gas - LNB. Een uitgebreide beschrijving van het volumebepalingsysteem is te vinden op de GTS website.

Onderdeel van de evaluatie is het toetsen van de realisatie van de verschillende kentallen aan de gestelde eisen in de Meetcode gas - LNB. Deze eisen betreffen de beschikbaarheid van de data, de maximale storingsduur van de meting en/of data acquisitie en de totale meetonzekerheid van de meetinrichting. Aanvullend is een overzicht gegeven van de kalibratieresultaten van de componenten van de meetinrichting.

In de evaluatie zijn de realisaties aan de eisen, als genoemd in artikel 1.3 van de Meetcode gas - LNB, getoetst. Een overzicht van de resultaten is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1

Functionele eis 'Meetcode gas LNB'		Voldaan Ja/Nee
Beschikbaarheid data per uur (gemiddelde op jaarbasis)	≥ 99%	Ja
Maximale storingsduur meting en/of data acquisitie	24 uur	Ja
Meetonzekerheid in hoeveelheid energie op maandbasis	≤ 1%	Ja
Meetonzekerheid in hoeveelheid energie per uur	≤ 2%	Ja

4. DATA BESCHIKBAARHEID

4.1. Functionele eisen

De functionele eis uit de Meetcode gas - LNB luidt:


Beschikbaarheid data per uur (gemiddelde op jaarbasis) $\geq 99\%$

Deze eisen gelden op basis van 95% betrouwbaarheid.

4.2. Realisatie periode 2020

De beschikbaarheid van de data is bepaald van alle 1046 aansluitingen/systeemverbindingen met in totaal 2536 meetstraten. De gemiddelde beschikbaarheid over de periode 2020 bedraagt 99,87%.

Het onderstaande histogram geeft de verdeling weer van de data beschikbaarheid.

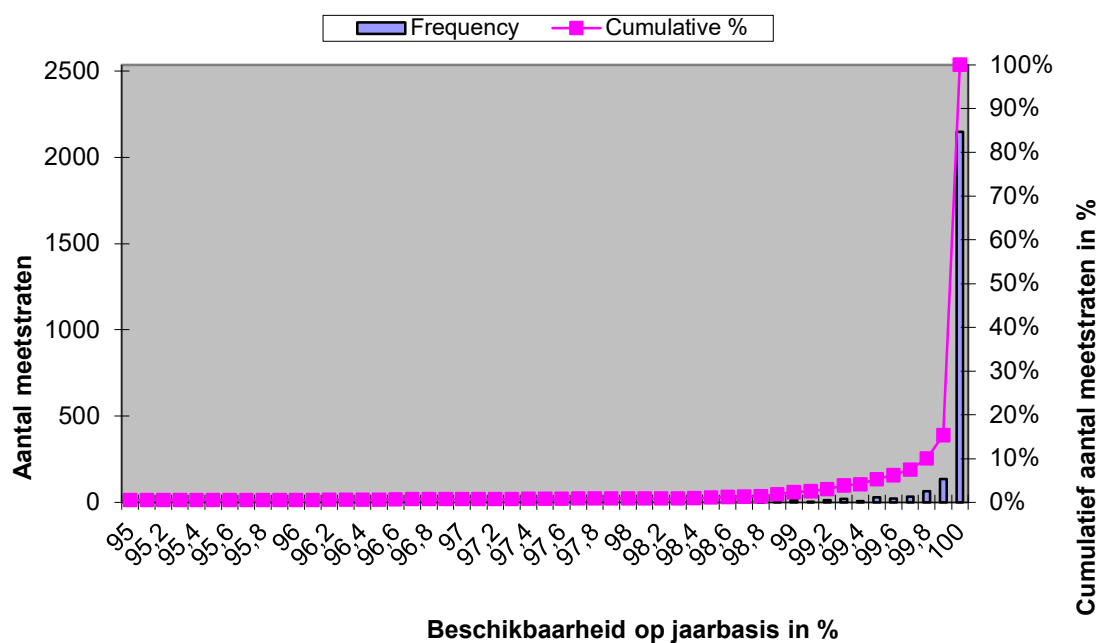

5. STORINGSDUUR METING EN/OF DATA ACQUISITIE

5.1. Functionele eisen

De functionele eis uit de Meetcode gas - LNB luidt:

<i>Maximale storingsduur meting en/of data acquisitie</i>	<i>24 uur</i>
---	---------------

Deze eisen gelden op basis van 95% betrouwbaarheid.

5.2. Realisatie periode 2020

Uit paragraaf 4.2 blijkt een gemiddelde onbeschikbaarheid van de data van 0,13%.

Deze onbeschikbaarheid¹ voor de periode 2020 bestaat uit:

- 4377 gebeurtenissen waarin de meting en/of data acquisitie ≥ 1 uur onbeschikbaar was
- waarvan 180 gebeurtenissen waarbij de onbeschikbaarheid van de meting en/of data acquisitie langer dan 24 uur is geweest

Uit de bovenstaande registraties kan worden afgeleid dat:

- de gemiddelde tijdsduur van de onbeschikbaarheid per gebeurtenis 6,6 uren bedroeg.
- in 4,11% van de gebeurtenissen de onbeschikbaarheid van de meting en/of data acquisitie langer duurde dan 24 uur.

¹ Een onbeschikbaarheid van 0,13% voor de 2536 meetstraten resulteert er in dat van het theoretisch aantal uurwaarden van 22.276.224 (=365 dagen * 24 uurwaarden * 2536 meetstraten) er slechts 28959 uurwaarden (=0,13%) niet beschikbaar zijn geweest.


6. GASMETER

6.1. Functionele eisen

De functionele eisen uit de Meetcode gas - LNB luiden:

Bij de hoogste druk waarbij gekalibreerd wordt is de miswijzing $\leq 0,5\%$ in het gebied tussen $0,25 \cdot Q_{\max}$ en $Q_{\max}$

De criteria waaraan een turbinegasmeter dient te voldoen zijn samengevat in onderstaande figuur.

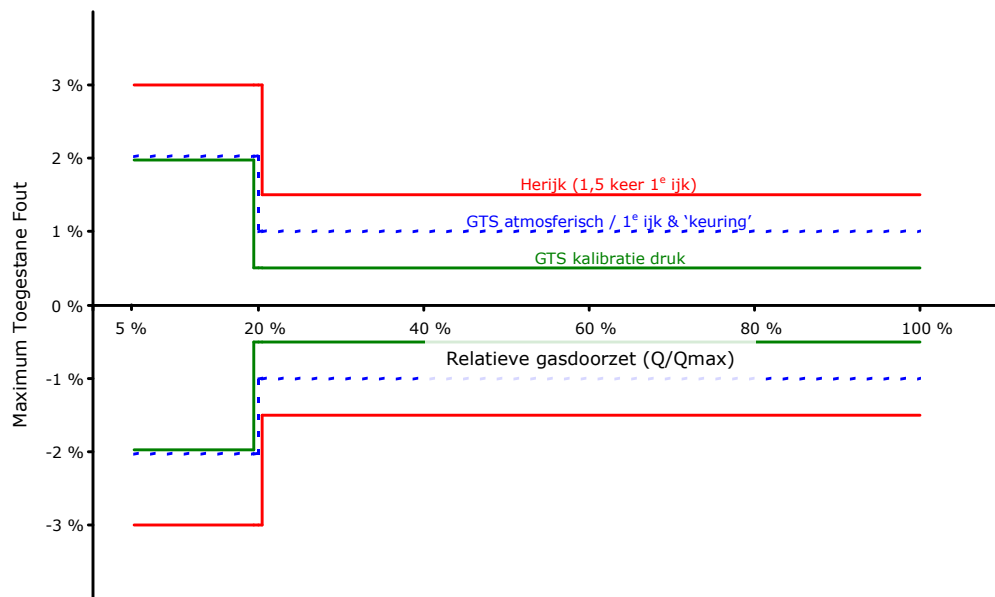

Alle meters die worden geplaatst zijn voorzien van een certificaat en worden getoetst op bovenstaande eisen voordat deze worden ingebouwd. Iedere aangeslotene kan deze certificaten elektronisch opvragen via de website GTS-Gasport voor de gasmeters die aanwezig zijn in haar aansluiting(en) en/of systeemverbinding(en).


6.2. Realisatie jaarlijkse steekproef gasmeters over de periode 2020

De controle op in gebruik zijnde gasmeters vindt plaats middels een jaarlijkse steekproef. In het kader van de steekproef 2020 zijn hiervoor 60 gasmeters uitgebouwd en gekalibreerd bij de hoogste werkdruk.

6.2.1 Flowgewogen gemiddelde miswijzing bij de hoogste druk waarbij is geijkt

Bij een kalibratie wordt de flowgewogen gemiddelde miswijzing bepaald bij $5\% \cdot Q_{\max}$, $10\% \cdot Q_{\max}$, $25\% \cdot Q_{\max}$, $40\% \cdot Q_{\max}$, $70\% \cdot Q_{\max}$ en $100\% \cdot Q_{\max}$. De flowgewogen gemiddelde

miswijzing (zie [4]) van de gasmeters bedraagt 0,0203%. De standaarddeviatie van de flowgewogen miswijzing bedraagt 0,208%.
 Het onderstaande histogram geeft de verdeling weer van de flowgewogen miswijzing.

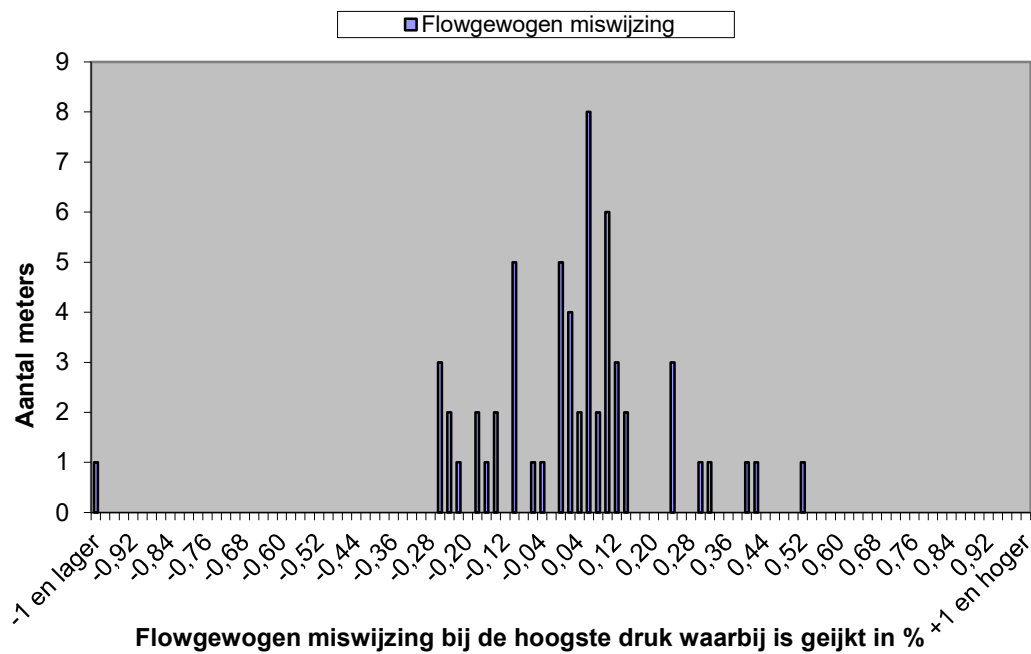

7. VOLUMEHERLEIDINGSINSTRUMENT (EVHI)

7.1. Functionele eisen

De functionele eisen uit de Meetcode gas - LNB voor de bepaling van de hoeveelheid gas onder normaal condities met de pTz methode luiden :

<i>Herleidingsfout</i>	$\leq 0,5\%$
<i>Vershil herleidingsfout tussen 2 controle metingen</i>	$\leq 0,3\%$
<i>Fout drukopnemer</i>	$\leq 0,4\%$
<i>Fout temperatuuropnemer</i>	$\leq 0,5K$
<i>HF/LF-fout</i>	$\leq 0,1\%$


7.2 Realisatie EVHI's over de periode 2020

De EVHI's worden 1 keer per jaar gekalibreerd. Tijdens deze kalibratie worden de in paragraaf 7.1 genoemde fouten bepaald. Het aantal uitgevoerde controlemetingen in 2020 bedraagt 4848.

7.2.1 Herleidingsfout

De gemiddelde afwijking van de herleidingsfout bedraagt -0,0248% waarbij 99,8% een afwijking met een absolute waarde van minder dan 0,5% heeft. De standaarddeviatie van de afwijking bedraagt 0,821%.


Het onderstaande histogram geeft de verdeling weer van de geregistreerde afwijkingen.

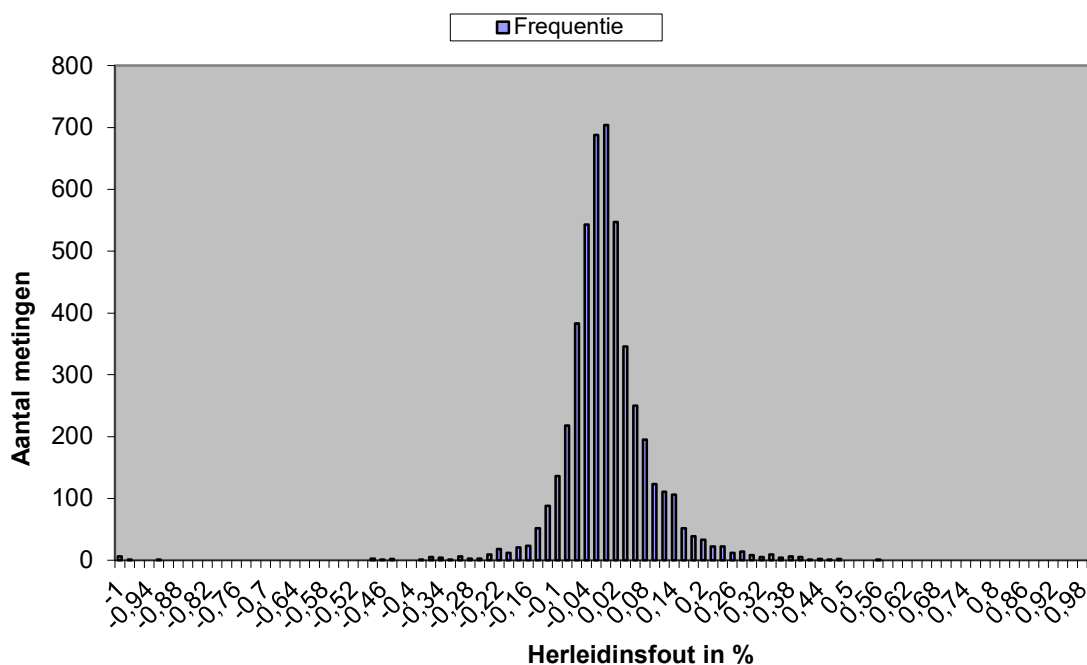

7.2.2 Verschil herleidingsfout tussen 2 metingen

Het gemiddelde verschil tussen 2 controlemetingen bedraagt 0,002% waarbij geen meting een verschil groter dan 0,3% absoluut lieten zien. De standaarddeviatie van de afwijking bedraagt 0,041%.


Het onderstaande histogram geeft de verdeling weer van de geregistreerde afwijkingen.

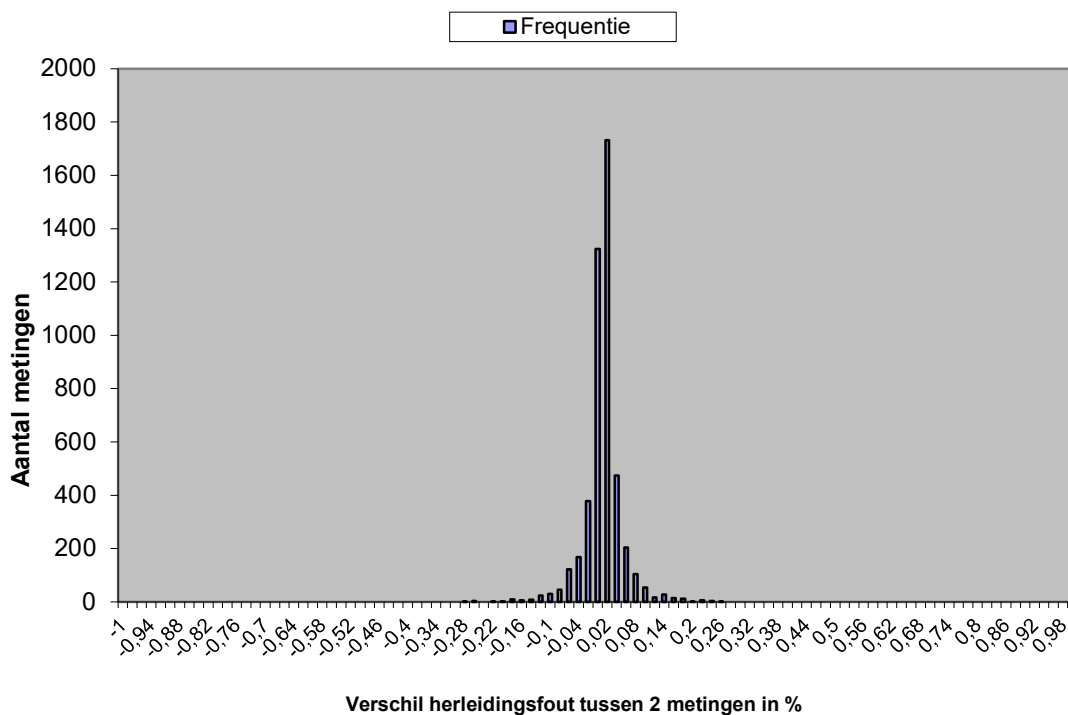

7.2.3 Fout drukopnemer

De gemiddelde afwijking van de drukopnemers bedraagt 0,000 % waarbij 99,92% een afwijking met een absolute waarde van minder dan 0,4% heeft. De standaarddeviatie van de afwijking bedraagt 0,069%.


Het onderstaande histogram geeft de verdeling weer van de geregistreerde afwijkingen.

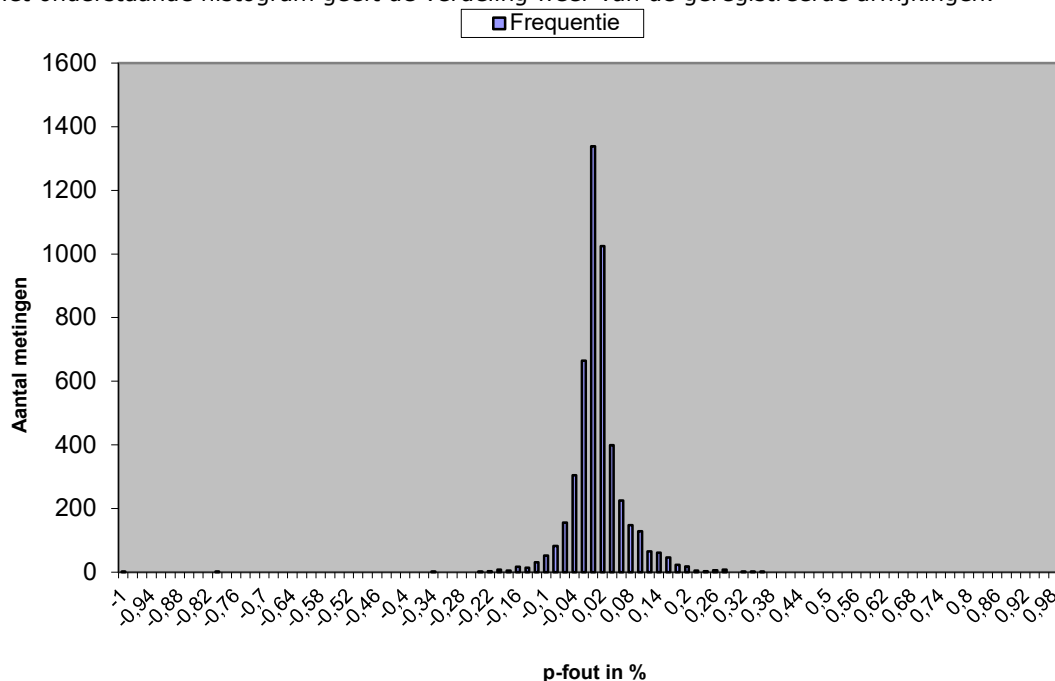

7.2.4 Fout temperaturopnemer

De gemiddelde afwijking van de temperaturopnemers bedraagt -0,023K waarbij 99,3% een afwijking met een absolute waarde van minder dan 0,5K heeft. De standaarddeviatie van de afwijking bedraagt 0,163K.


Het onderstaande histogram geeft de verdeling weer van de geregistreerde afwijkingen.

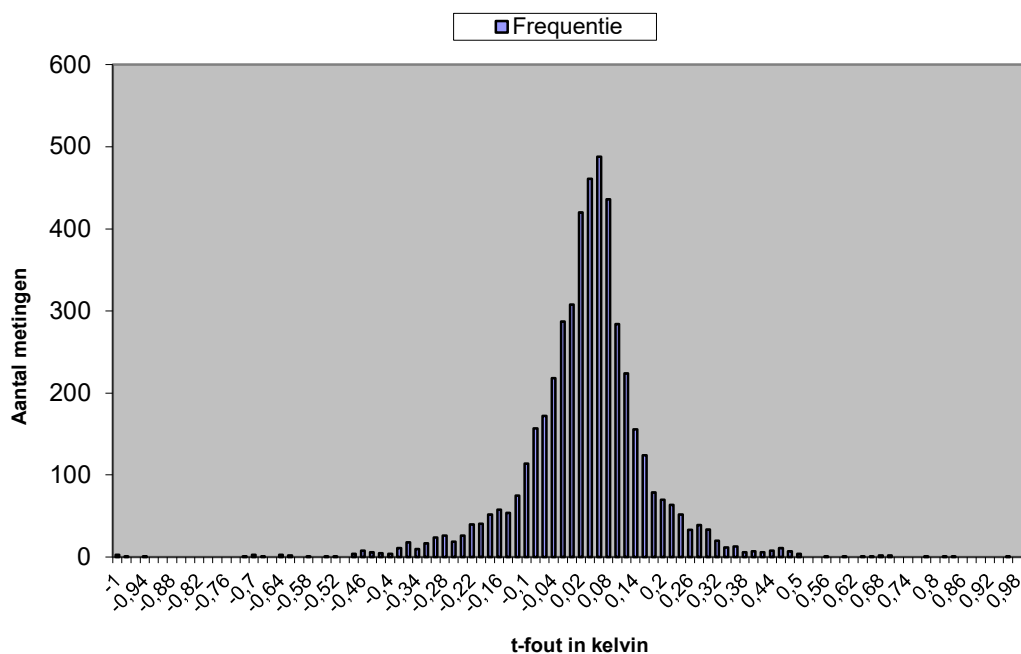

7.2.5 HF/LF-fout

De gemiddelde HF/LF-fout bedraagt 0,105% waarbij 99,1% een afwijking met een absolute waarde van minder dan 0,1% heeft. De standaarddeviatie van de afwijking bedraagt 3,427%.

Het onderstaande histogram geeft de verdeling weer van de geregistreerde afwijkingen.

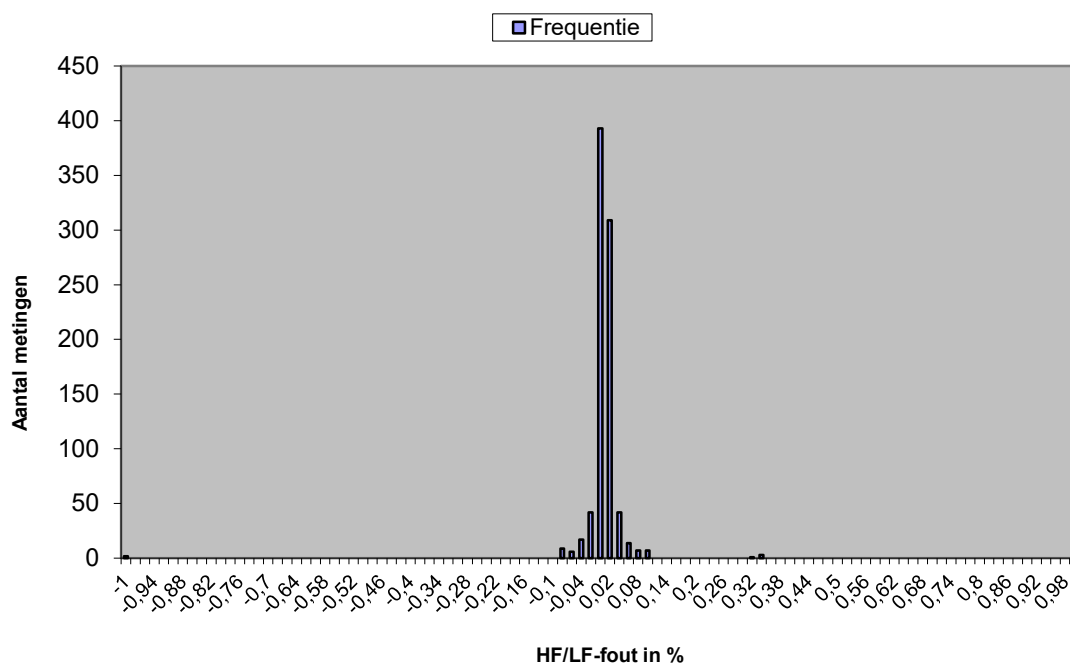

8. TESTGASRESULTATEN

8.1. Functionele eis

De functionele eis uit de Meetcode gas - LNB luidt:


De onnauwkeurigheid van de bepaling van de calorische bovenwaarde is niet groter dan 0,4% van de bepaalde waarde.

8.2. Realisatie periode 2020

Het aantal uitgevoerde testgas controles in 2020 is 1283.

De gemiddelde afwijking tussen de op het testgascertificaat vermelde calorische bovenwaarde en de uit de meting bepaalde calorische bovenwaarde bedraagt -0,034%. De standaarddeviatie van de afwijking bedraagt 0,038%.

Het onderstaand histogram geeft de verdeling weer van de geconstateerde afwijkingen.

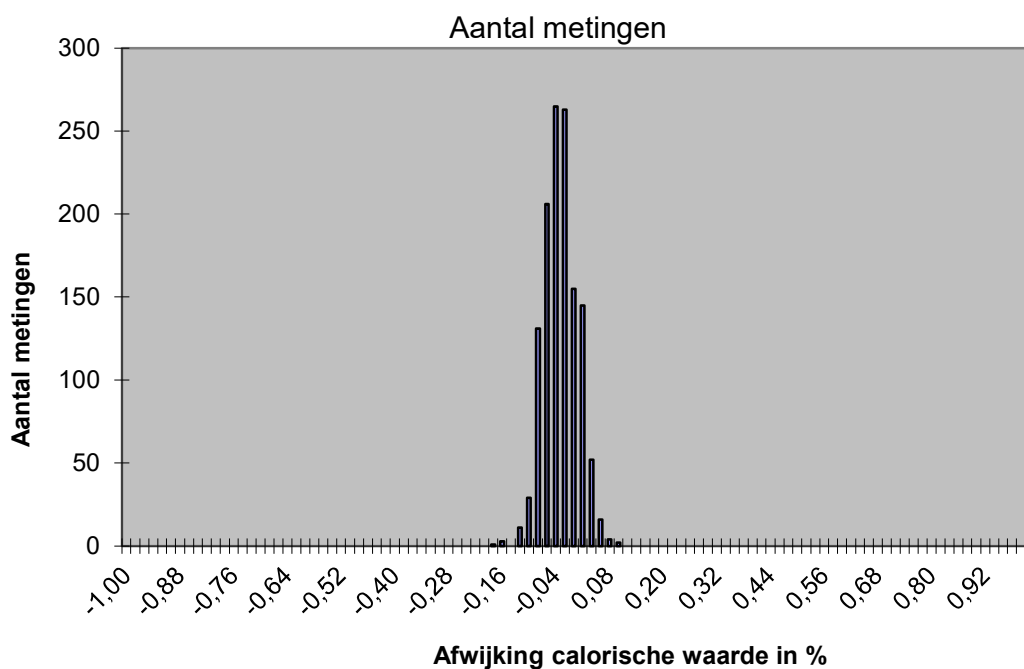

9. MEETONZEKERHEID

9.1. Functionele eisen

De functionele eisen uit de Meetcode gas - LNB luiden:

Meetonzekerheid in hoeveelheid energie op maandbasis $\leq 1\%$

Meetonzekerheid in hoeveelheid energie per uur $\leq 2\%$

Deze eisen gelden op basis van 95% betrouwbaarheid.

9.2. Realisatie meetonzekerheid voor de periode 2020

Op basis van de resultaten van de steekproef turbinemeters (zie 6.2), de kalibratieresultaten van de druk- en temperatuuropnemers (zie 7.2.3 en 7.2.4) en de GC testgasresultaten (zie 8.2) kan worden getoetst of aan bovengenoemde eisen is voldaan.

De meetonzekerheid in de energiehoeveelheid per uur is opgebouwd uit de meetonzekerheid in de energie hoeveelheid per maand, het effect van pulsoverdracht² en een bijdrage van het gaskwaliteitsysteem³.

Het resultaat van de berekening staat in

tabel 2

parameter	scn [%]	2 sigma [%]	gf [%]	doorwerkingsfactor f
turbinemeter	0,24	0,58	0,63	1,00
installatie-effect	0,20		0,20	1,00
drukopnemer	0,10	0,14	0,17	1,08
temperatuuropnemer	0,03	0,12	0,13	-1,30
z-berekening	0,10		0,10	1,00
calorische waarde	0,15	0,11	0,19	1,13
meetonzekerheid in energie hoeveelheid per maand			0,74	
onzekerheid pulsoverdracht			0,75	
onzekerheid gaskwaliteitsysteem			1,5	
meetonzekerheid in energie hoeveelheid per uur			1,83	

hiermee is voldaan aan de functionele eisen uit de meetcode gas – Inb.

² vermeld.

Tabel 2

² Indien van toepassing geldt een additionele onzekerheid van 75%.

³ Variatie in de 24-uursgemiddelde van calorische waarde waarvoor getoetst wordt aan een maximaal toelaatbare afwijking van 1,5%.

Parameter	SCN [%]	2 sigma [%]	GF [%]	Doorwerkingsfactor f
Turbinemeter	0,24	0,58	0,63	1,00
Installatie-effect	0,20		0,20	1,00
Drukopnemer	0,10	0,14	0,17	1,08
Temperatuuropnemer	0,03	0,12	0,13	-1,30
Z-berekening	0,10		0,10	1,00
Calorische waarde	0,15	0,11	0,19	1,13
Meetonzekerheid in energie hoeveelheid per maand			0,74	
Onzekerheid pulsoverdracht			0,75	
Onzekerheid gaskwaliteitsysteem			1,5	
Meetonzekerheid in energie hoeveelheid per uur			1,83	

Hiermee is voldaan aan de functionele eisen uit de Meetcode Gas – LNB.

REFERENTIELIJST

- [1] Begrippencode Gas; <https://www.acm.nl/>
- [2] International Organization for Standardization; '*Quantities and units*'; EN-ISO 80000-1:2013; Geneva.
- [3] International Organization for Standardization; '*International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM)*'; ISO Guide 99:2007; Geneva.
- [4] Beschrijving Volumebepalingssysteem; www.gasunietransportservices.nl.
- [5] Beschrijving Gaskwaliteitssysteem; www.gasunietransportservices.nl

© 2021 Gasunie Transport Services BV

Postbus 181
9700 AD Groningen
(Concourslaan 17)

T 050 521 33 33
E customerdesk@gastransport.nl
www.gasunietransportseivices.nl